

SANOVIE®

sanovie.com.br

NEONATOLOGIA

PRODUTOS

Conlett

Neotech

SANOVIE

MARCELO LIMA

Director

Business development & Overseas business

+ 55 41 99963.3060 | + 55 41 3015.2697

sanovie.com.br



# Neobar ET Tuber Holder

## FIXADOR TUBO OROTRAQUEAL


### FINALIDADE:

FIXAR TUBO OROTRAQUEAL

REDUZIR RISCO DE EXTUBAÇÃO

PREVENIR TRAUMA DO PALATO (REDUZ O TORQUE)

ELIMINAR O USO DE FITAS ADESIVAS PRÓXIMAS DO NARIZ  
OU BOCA

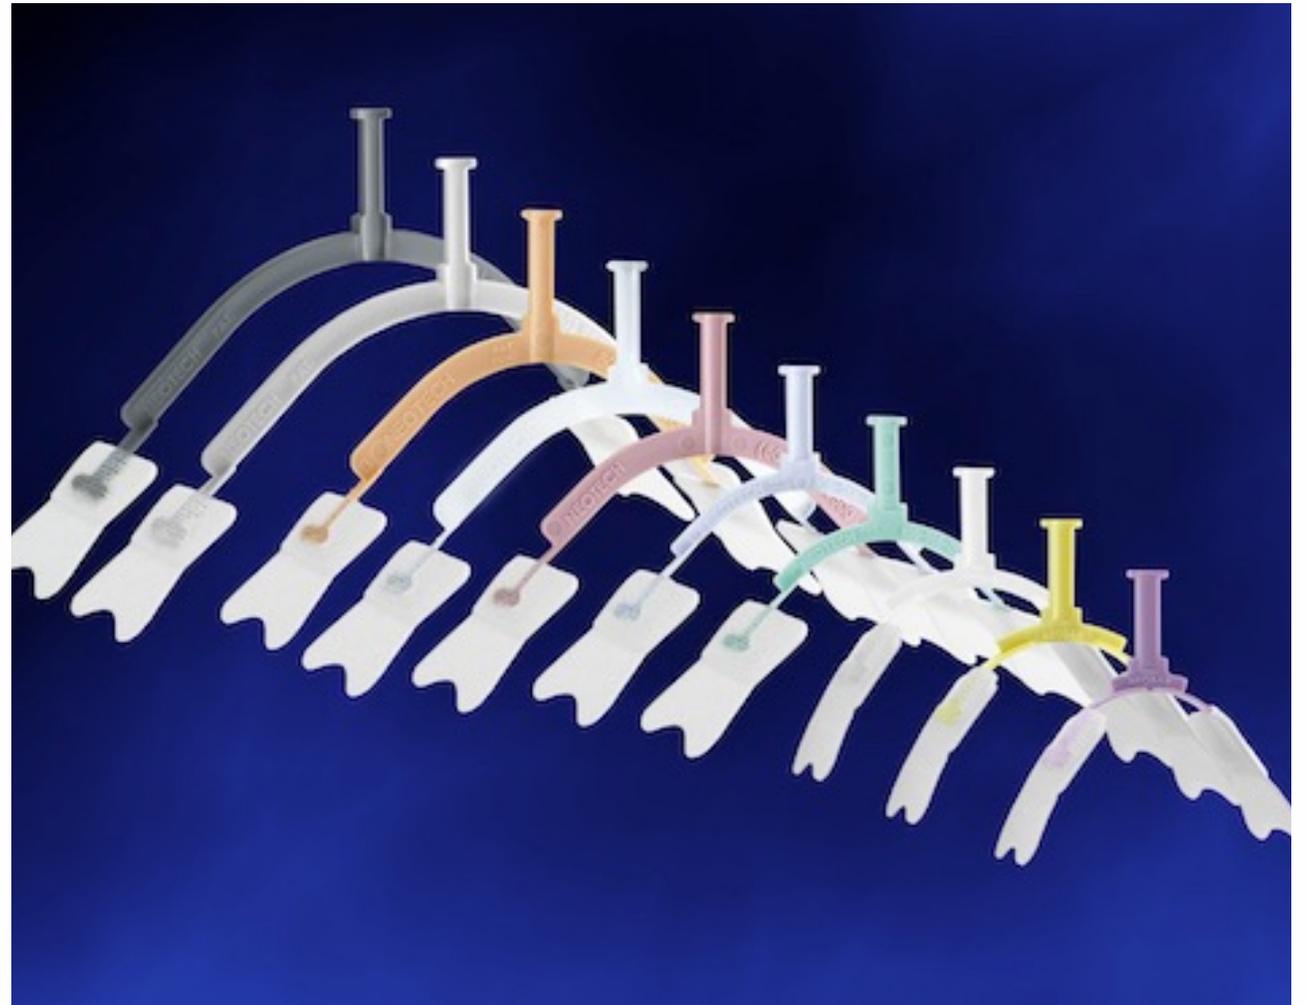


# Neobar ET Tuber Holder

## INDICAÇÃO:

- PACIENTES: PEDIÁTRICOS; NEONATOS, INFANTIS.

## CARACTERÍSTICAS:

- TIRAS ADESIVAS EM HIDROCOLOIDE
- TAMANHOS CODIFICADOS POR COR
- FÁCIL REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA
- GABARITO PARA DETERMINAÇÃO DO TAMANHO ADEQUADO

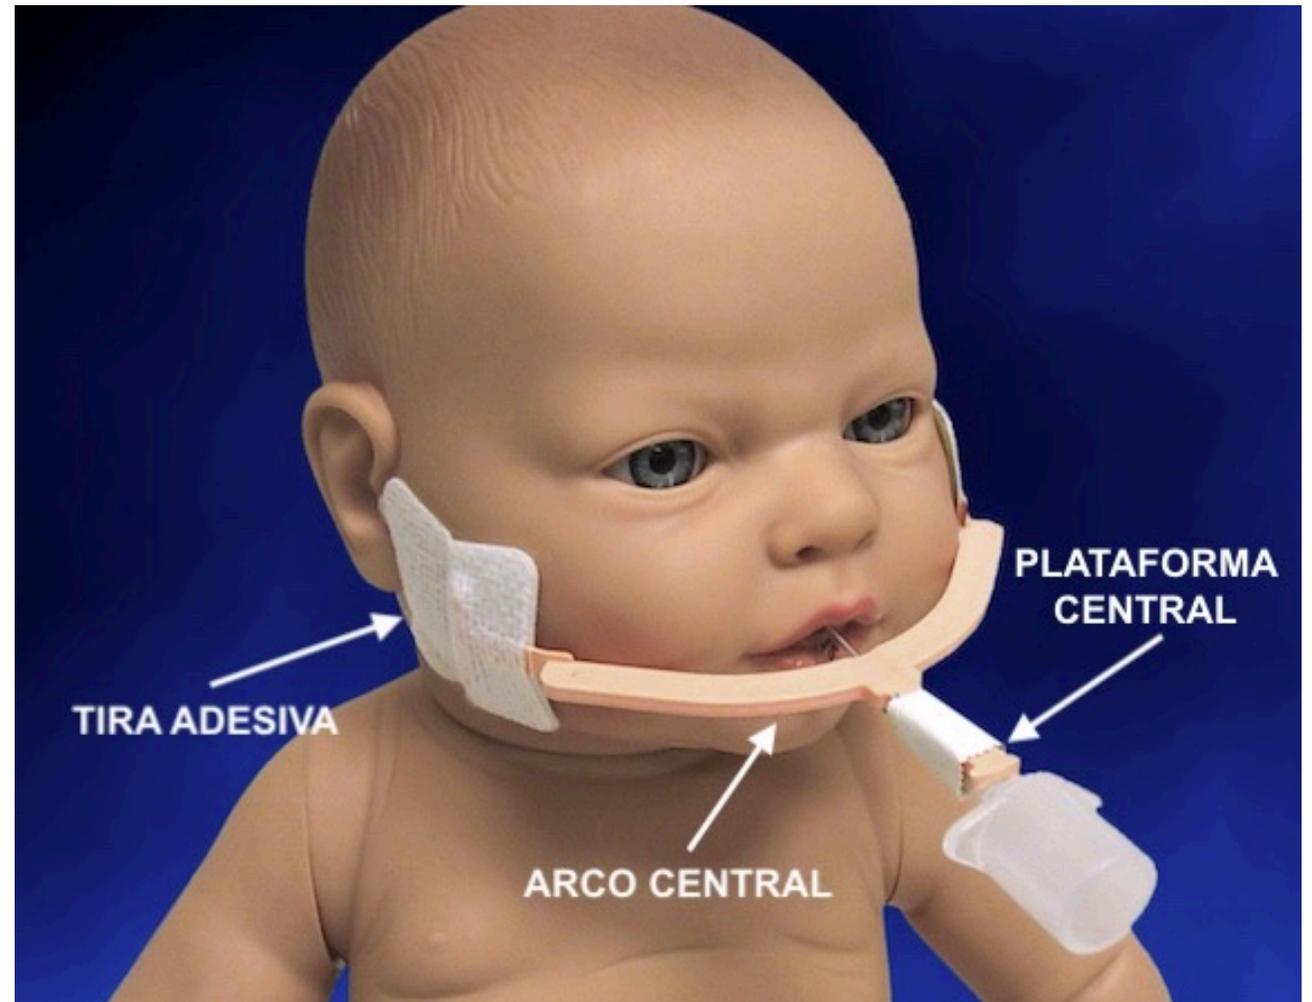

## Neobar ET Tuber Holder

- ESTABILIDADE
- RISCO DE ESTUBAÇÃO  
EXPONTÂNEA MINIMIZADO

PERIODICIDADE DE TROCA: A CADA  
CINCO DIAS OU DE ACORDO COM  
PROTOCOLO DO HOSPITAL



# Baby Warmer

SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PREVENÇÃO À HIPOTERMIA, MANUTENÇÃO DA NORMOTERMIA

## CARACTERÍSTICAS:

- IDEAL PARA PACIENTES PREMATUROS, PRÉ-TERMO E RECÉM NASCIDOS;
- TECNOLOGIA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, ALTA SEGURANÇA PARA O PACIENTE;
- EXCLUSIVO COLCHÃO D'ÁGUA PARA MAIOR CONFORTO, INDICADO SOBRETUDO PARA TRAUMA PÓS PARTO, HIDROCEFALIA, E PACIENTES COM DORES PÓS PARTO.



## Neo Photoshade

### PROTETOR OCULAR

FINALIDADE: PROTEÇÃO OCULAR DURANTE EXPOSIÇÃO À  
RAIOS EM FOTOTERAPIA

#### CARACTERÍSTICAS:

DISPENSA FIXAÇÕES ADICIONAIS, FACE ADESIVA EM  
SILICONE SUAVE E ATRAUMÁTICO

PERMITE REPOSICIONAMENTO, REUTILIZÁVEL DURANTE  
TODA TERAPIA

PAD CENTRAL EM ALGODÃO NEGRO, FILTRA 99,75% DOS  
RAIOS EMITIDOS



## Neo Photoshade

- SEGURANÇA: SEM RISCO DE DESLOCAMENTO
- MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE
- SKIN FRIENDLY



## Neo Guard

### PROTETOR CPAP NASAL

#### FINALIDADE:

PROTEGER E EVITAR DANOS OU IRRITAÇÃO NA MUCOSA E NO SEPTO NASAL DO NEONATO

ESTABILIZAR A CÂNULA DO CPAP

EVITA O CONTATO DIRETO DA CÂNULA COM A PELE DO BEBÊ



# Neo Guard

TAMANHOS SEGUEM O PADRÃO UNIVERSAL

- AJUSTE PRECISO
- VEDAÇÃO ASSEGURADA

FIXAÇÃO DO TUBO NA REGIÃO SUPRA LABIAL

- MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO PESO
- ESTABILIDADE DO CONJUNTO




## Chinstrap

ESTABILIZADOR DE MAXILAR

FINALIDADE:

MANTER A BOCA FECHADA DURANTE TERAPIA  
RESPIRATÓRIA

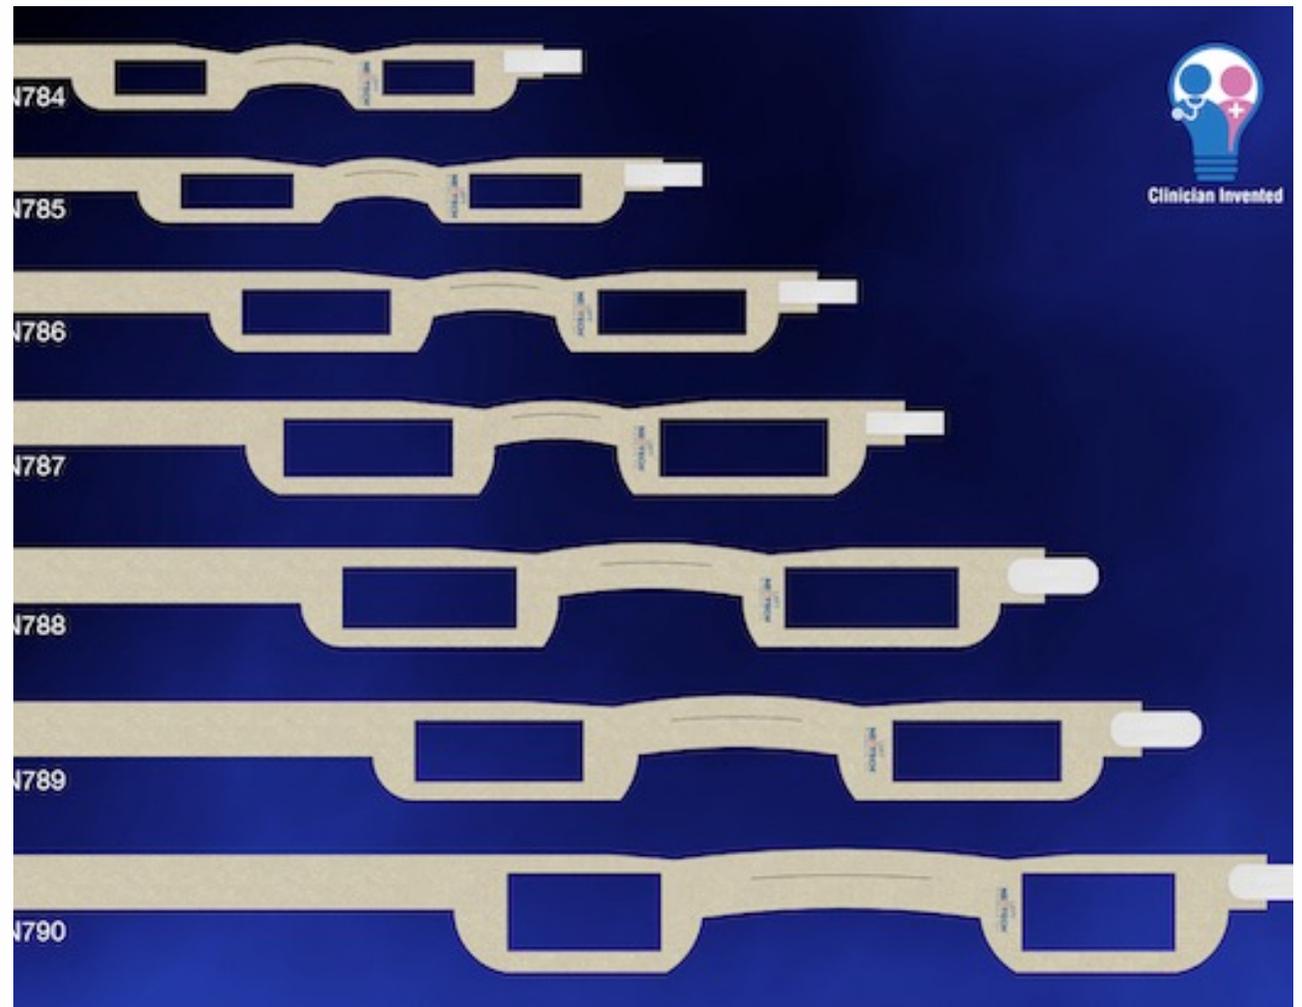

# Chinstrap

## INDICAÇÃO

PACIENTES: PEDIÁTRICOS; NEONATOS, INFANTIS.

## CARACTERÍSTICAS:

MACIO, TRANSPIRÁVEL, AJUSTÁVEL

FLEXÍVEL; PERMITE MINÍMO MOVIMENTO BUCAL

DESIGN DE QUEIXO DIVIDIDO, PARA MAIOR CONFORTO E ESTABILIDADE

ABERTURAS DE ORELHAS PARA EVITAR DOBRAS

FEITO EM MATERIAL ESPECIAL QUE EVITA O DESLIZAMENTO



# Sonic Muffs

## PROTETOR COCLEAR

FINALIDADE: ESPECIALMENTE PROJETADO PARA PROTEGER A COCLEAR IMATURA DO BEBÊ PREMATURO

### CARACTERÍSTICAS:

**PROTEGE EFETIVAMENTE A COCLEAR IMATURA DURANTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA**

CONFERE PADRÃO DE SONO MAIS ESTÁVEL

DIMINUIÇÃO DE PULSO E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA

ESTABILIDADE FISIOLÓGICA MELHORADA

REDUZ EM 7dB E EM 50% MENOS PRESSÃO NA COCLEAR



# Neolead

ELETRODOS PRÉ-CABEADOS

BORDAS EM HIDROCOLOIDE NEOBOND®

- EVITA QUE O CENTRO DE HIDROGEL ESCORRA E SEQUE PREMATURAMENTE
- FORNECE MAIOR ESTABILIDADE AO SENSOR PARA MELHOR DETECÇÃO
- MINIMIZA O DESLIZAMENTO
- RADIO TRANSPARENTE



# Neobridge


## FIXADOR CATETER UMBILICAL

FINALIDADE:

ANCORAR E SUPORTAR O CATETER UMBILICAL

REDUZIR "STRESS" SOBRE O CATETER

EVITAR DESLOCAMENTO

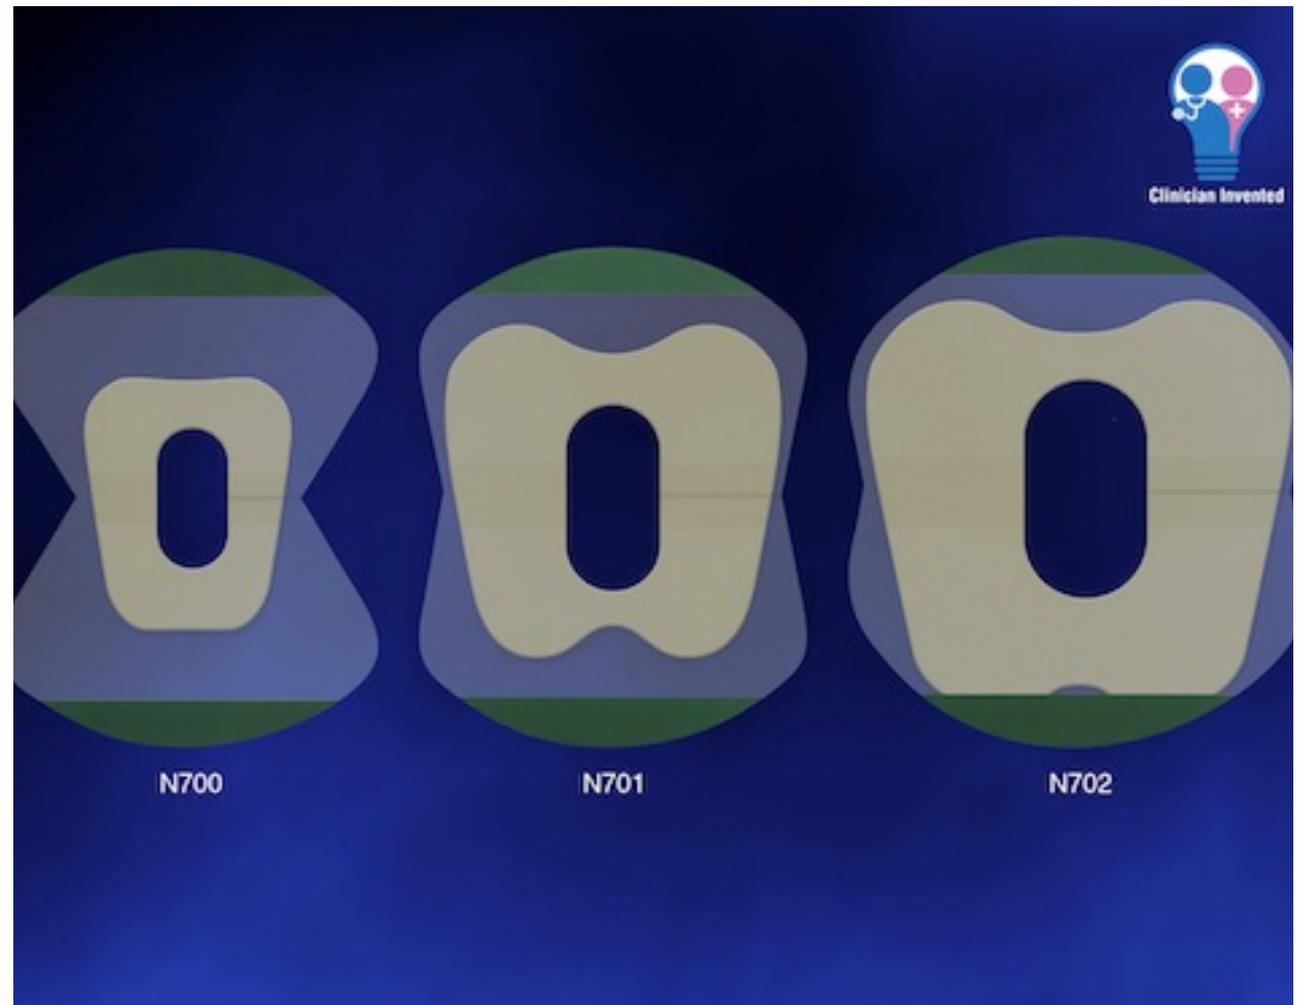

# Neobridge

## INDICAÇÃO

PACIENTES: PEDIÁTRICOS; NEONATOS, INFANTIS.


CARACTERÍSTICAS:

BASE ADESIVA EM HIDROCOLOIDE

ACOMODA ATÉ DOIS CATETERES

FLAPS TRANSPARENTES PARA VISUALIZAÇÃO DO CATETER

PERMITE REPOSICIONAMENTO DO CATETER

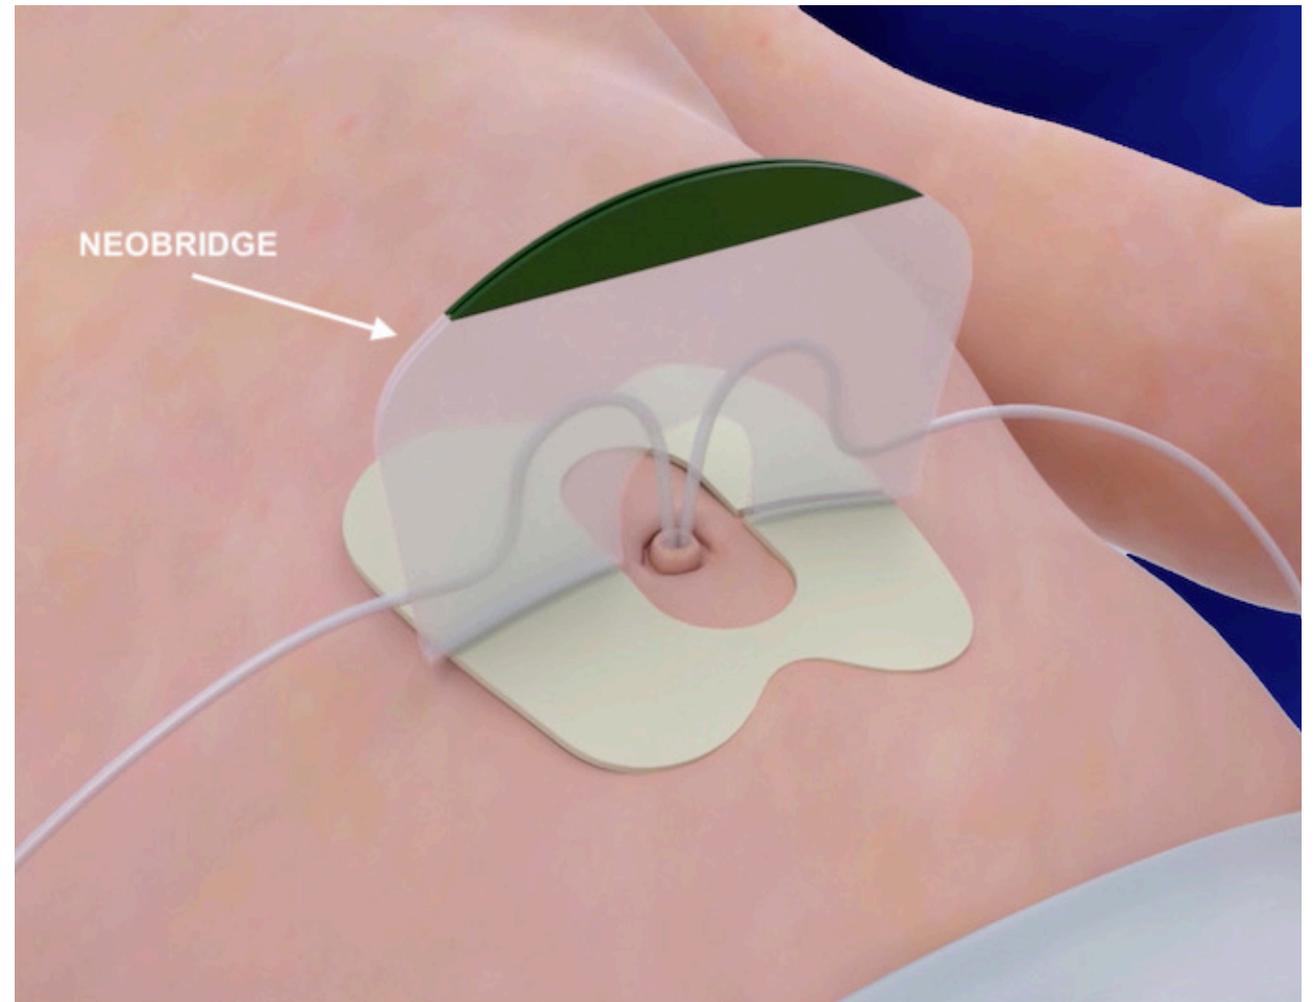

# Hold A Line

## FIXADOR CATETER UMBILICAL

### FINALIDADE:

ANCORAR E SUPORTAR O CATETER UMBILICAL

REDUZIR "STRESS" SOBRE O CATETER

EVITAR DESLOCAMENTO



# Hold A Line

## INDICAÇÃO

PACIENTES: PEDIÁTRICOS; NEONATOS, INFANTIS.


CARACTERÍSTICAS:

BASE ADESIVA EM HIDROCOLOIDE

SEU DESENHO ÚNICO PERMITE COTO UMBILICAL PROTUBERANTE

FLAP TRANSPARENTES PARA VISUALIZAÇÃO DO CATETER

PERMITE REPOSICIONAMENTO DO CATETER

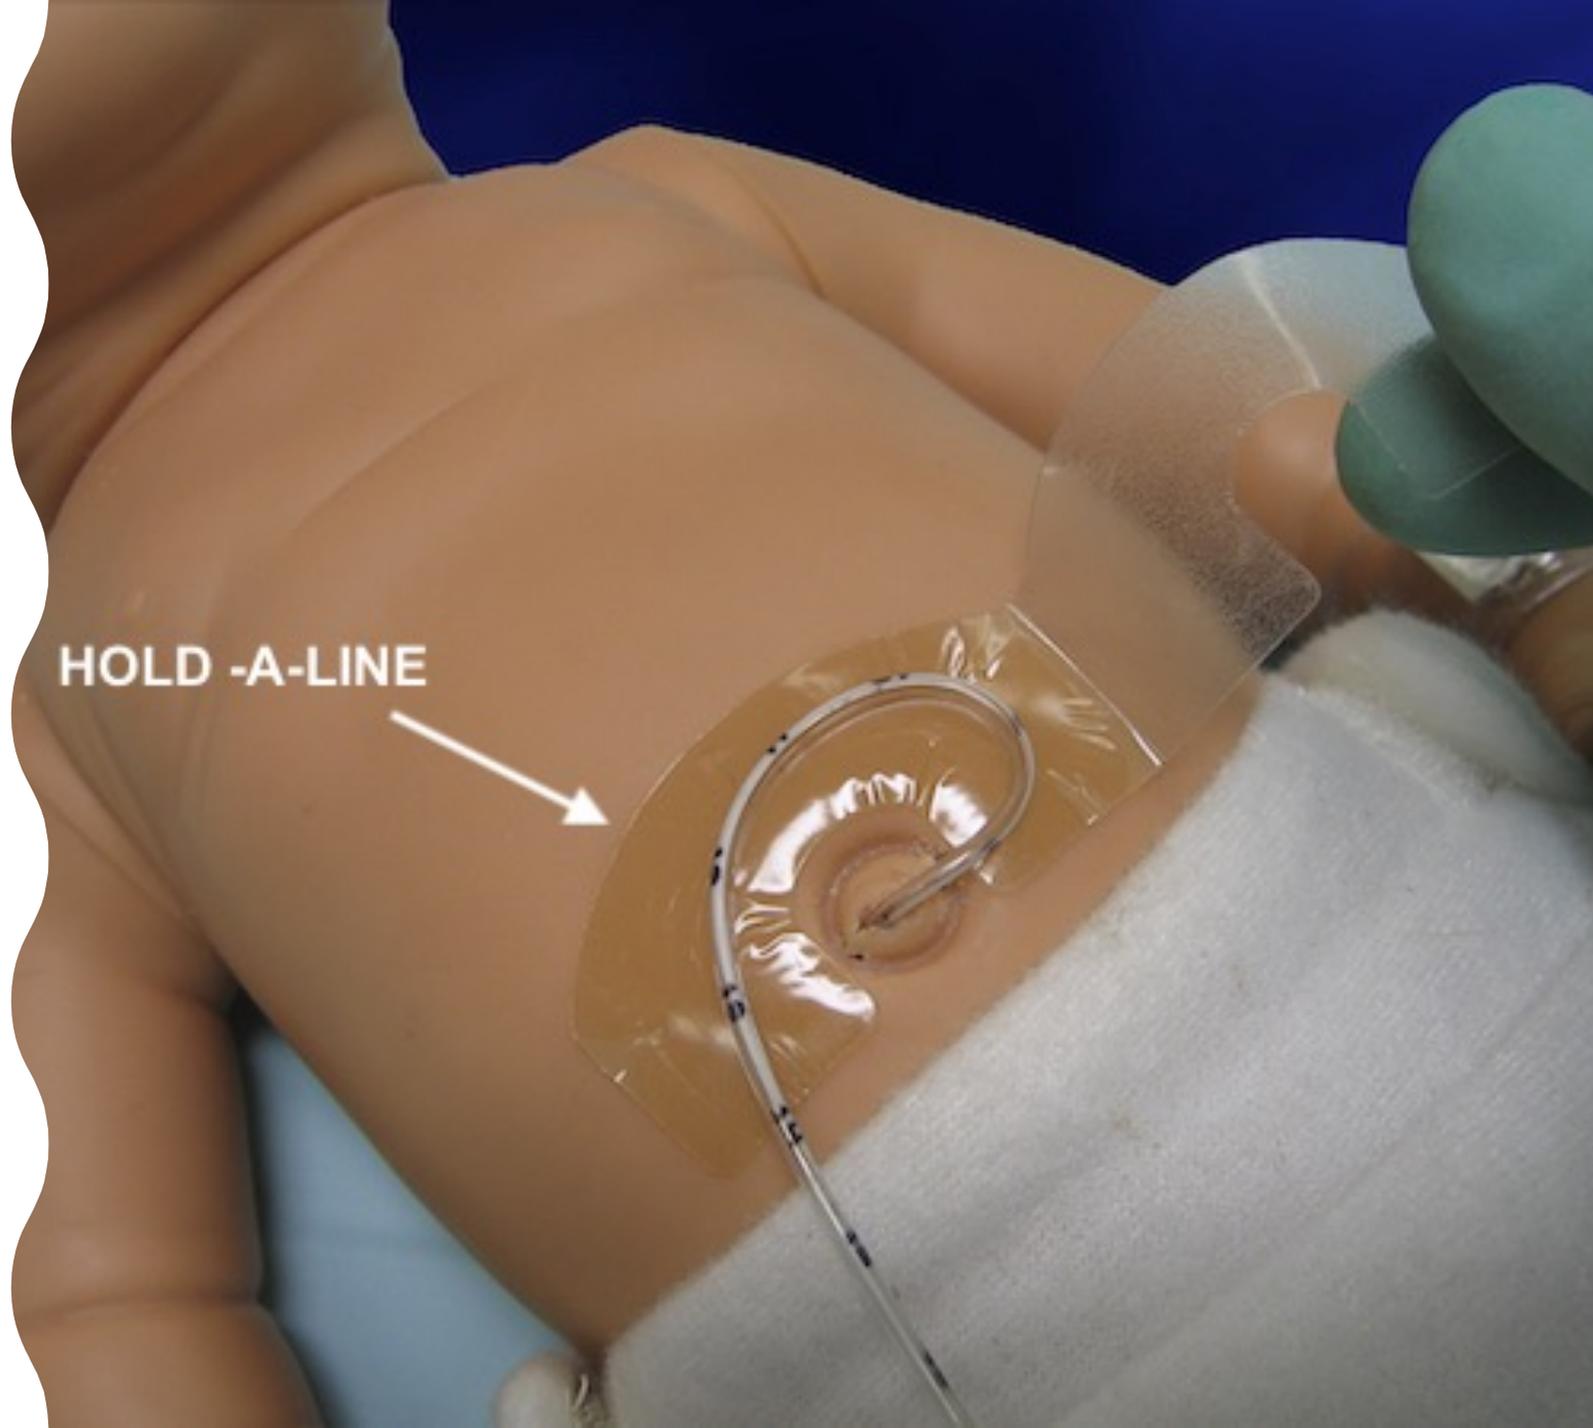

# Little Sucker Nasal Tip

## CÂNULA DE ASPIRAÇÃO NASAL

FINALIDADE: ASPIRAÇÃO DE FLUÍDOS NASAIS


CARACTERÍSTICAS:

DESENHADO PARA MINIMIZAR POTENCIAL TRAUMA TISSULAR

PERMITE SUCÇÃO INTERMITENTE

USO COM UMA SÓ MÃO

LIVRE DE LATEX E DEHP(FLALATO)

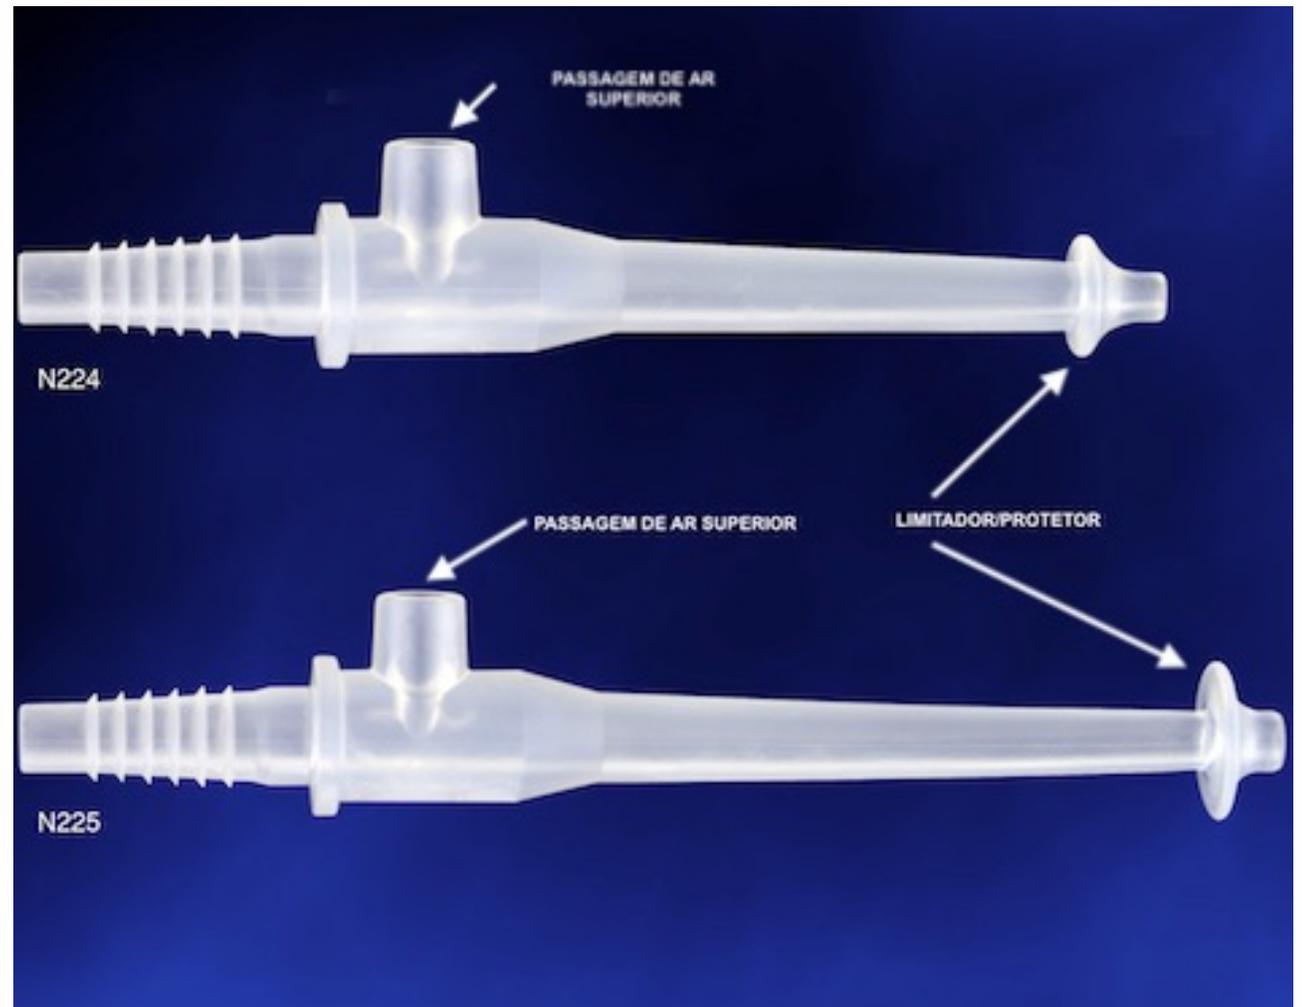

# Little Sucker

CÂNULA DE ASPIRAÇÃO NASAL E ORAL

FINALIDADE: ASPIRAÇÃO DE FLUÍDOS NASAIS E ORAIS


CARACTERÍSTICAS:

MACIO E FLEXÍVEL

PERMITE SUCÇÃO INTERMITENTE

USO COM UMA SÓ MÃO

LIVRE DE LATEX E DEHP(FLALATO)

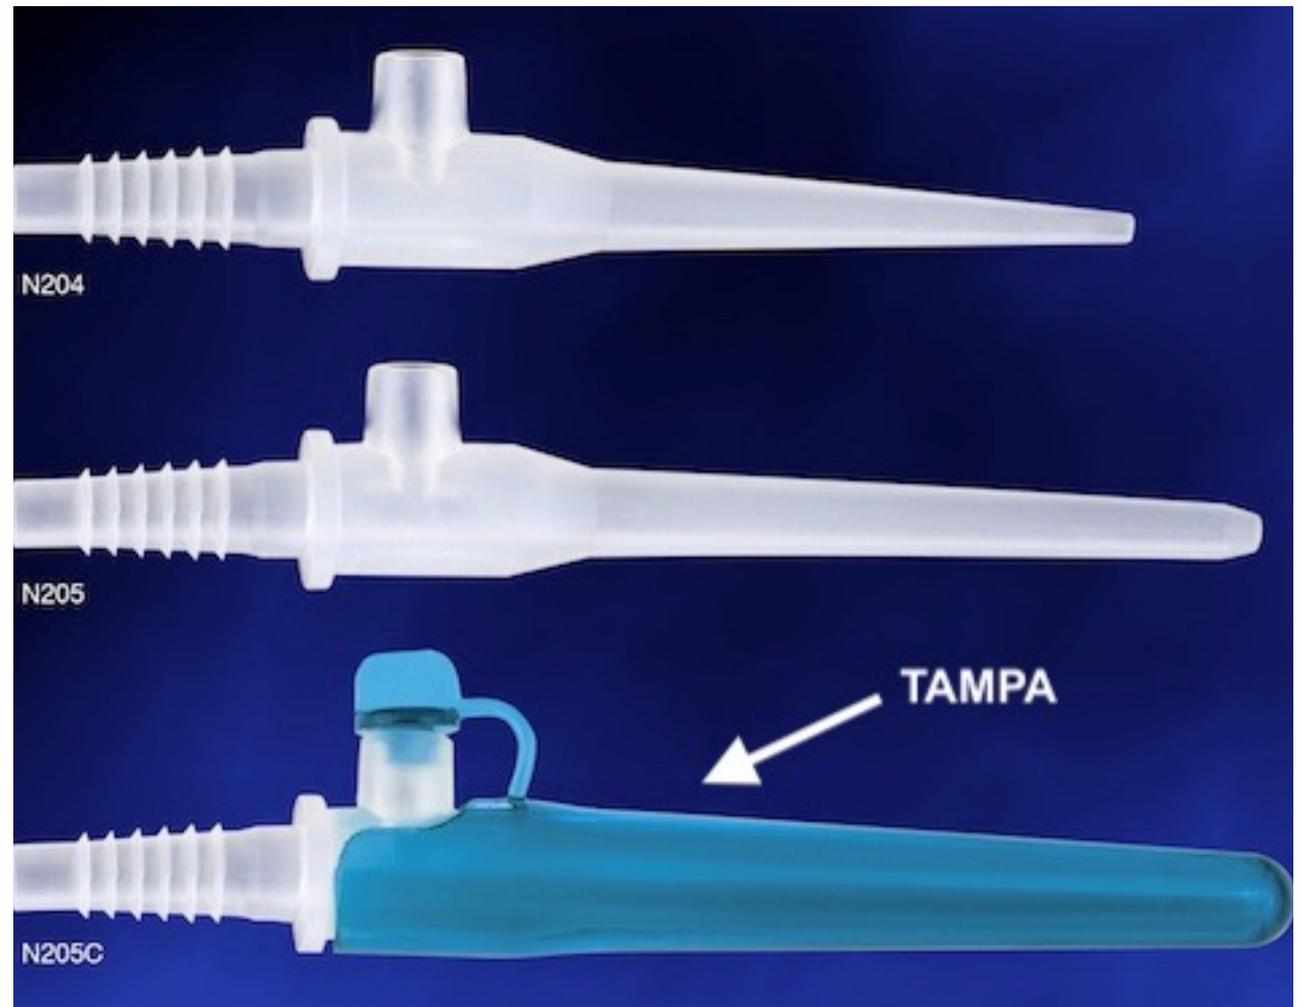

# Neosucker Curved

CÂNULA CURVA DE ASPIRAÇÃO NASAL E ORAL

FINALIDADE: ASPIRAÇÃO DE FLUÍDOS NASAIS E ORAIS

CARACTERÍSTICAS:

MACIO E FLEXÍVEL, DESENHO ANATÔMICO

PERMITE SUCÇÃO INTERMITENTE

USO COM UMA SÓ MÃO

LIVRE DE LATEX E DEHP(FLALATO)




## Neopulse

### CINTA PARA SENSOR DE OXIMETRO

FINALIDADE:

AUXILIAR NA FIXAÇÃO E EVITAR O DESLOCAMENTO DO SENSOR DE OXIMETRO

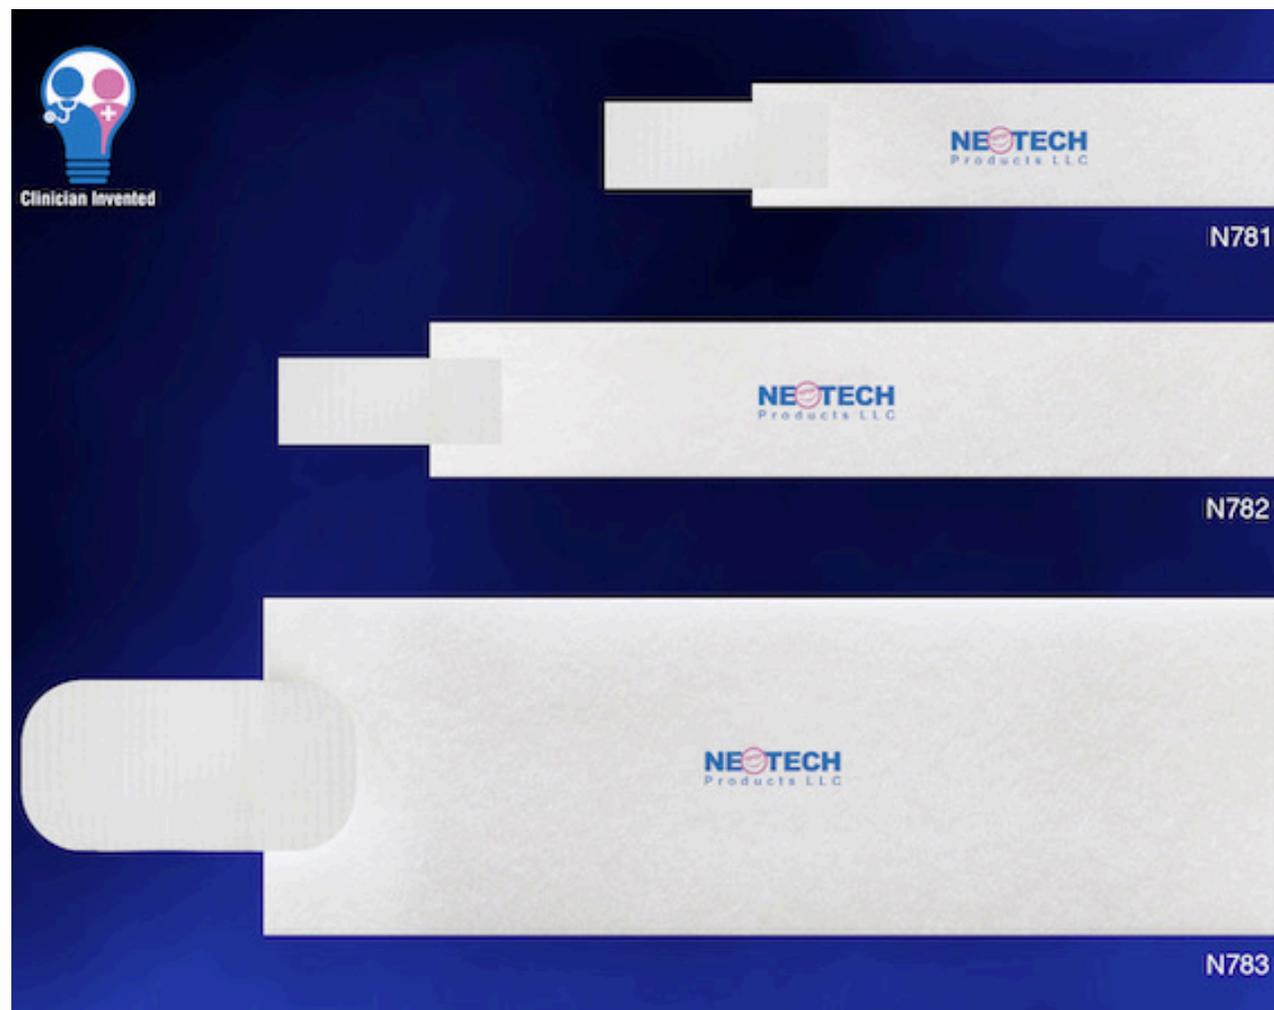

# Neopulse

## INDICAÇÃO

PACIENTES: PEDIÁTRICOS; NEONATOS, INFANTIS.

## CARACTERÍSTICAS:

MACIO

TRANSPIRÁVEL

AJUSTÁVEL

LEVE

DESENHADO PARA CONFORTO E ESTABILIDADE




## Neo Velum

FIXADOR DE SONDAS E TUBOS DE OXIGÊNIO

FINALIDADE:

FIXAR SONDAS NASOENTERAIS, TUBOS DE OXIGÊNIO E TUBOS DE CPAPs

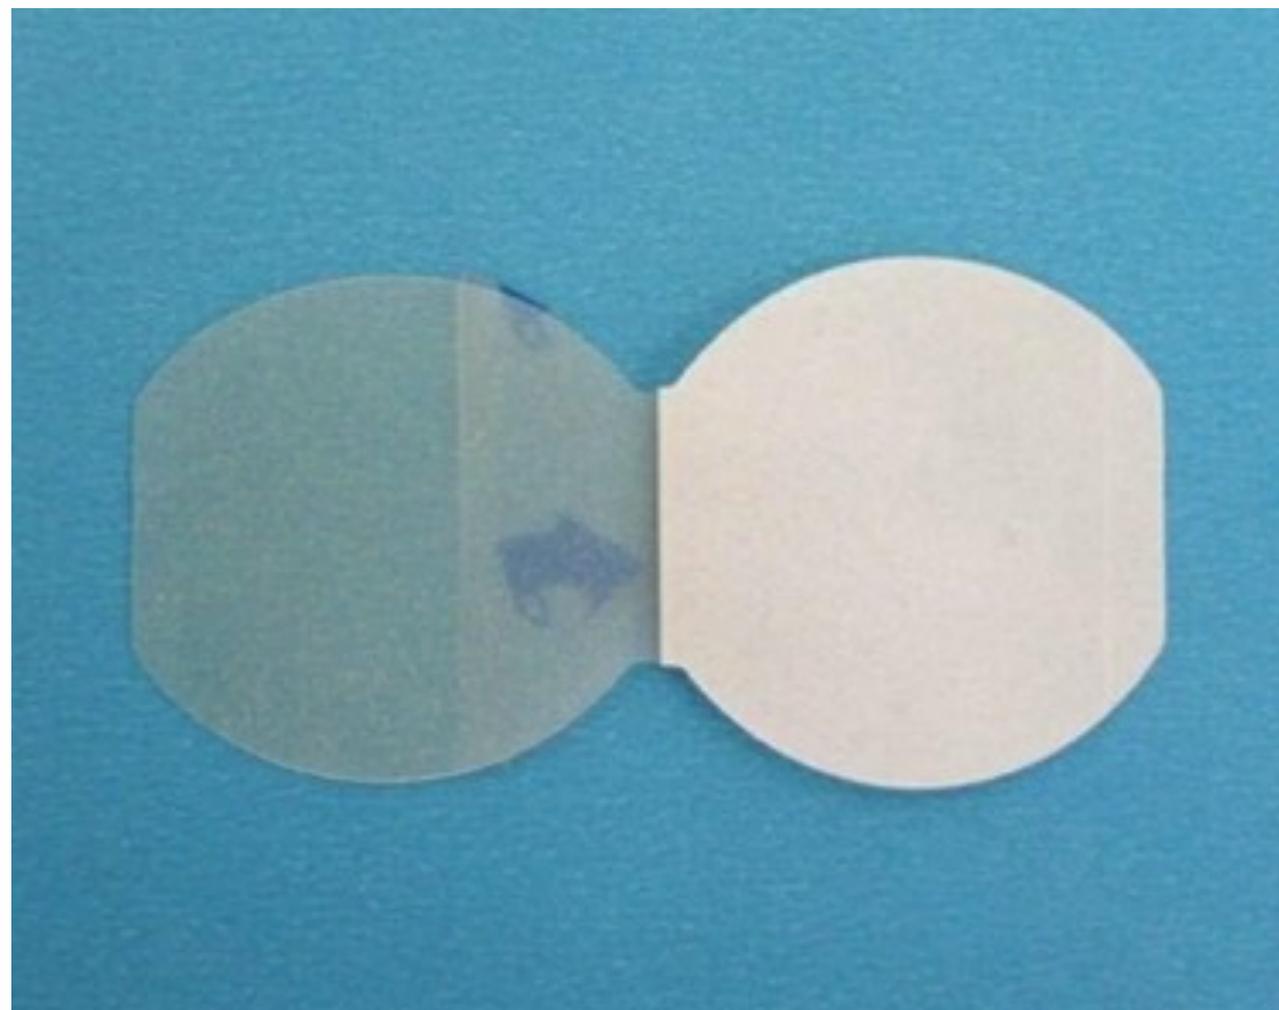

# Neo Velum

## INDICAÇÃO


PACIENTES: PEDIÁTRICOS; NEONATOS, INFANTIS.

## CARACTERÍSTICAS:

ESTÉRIL

BASE ADESIVA EM HIDROCOLOIDE

FIXAÇÃO ESTÁVEL E SEGURA

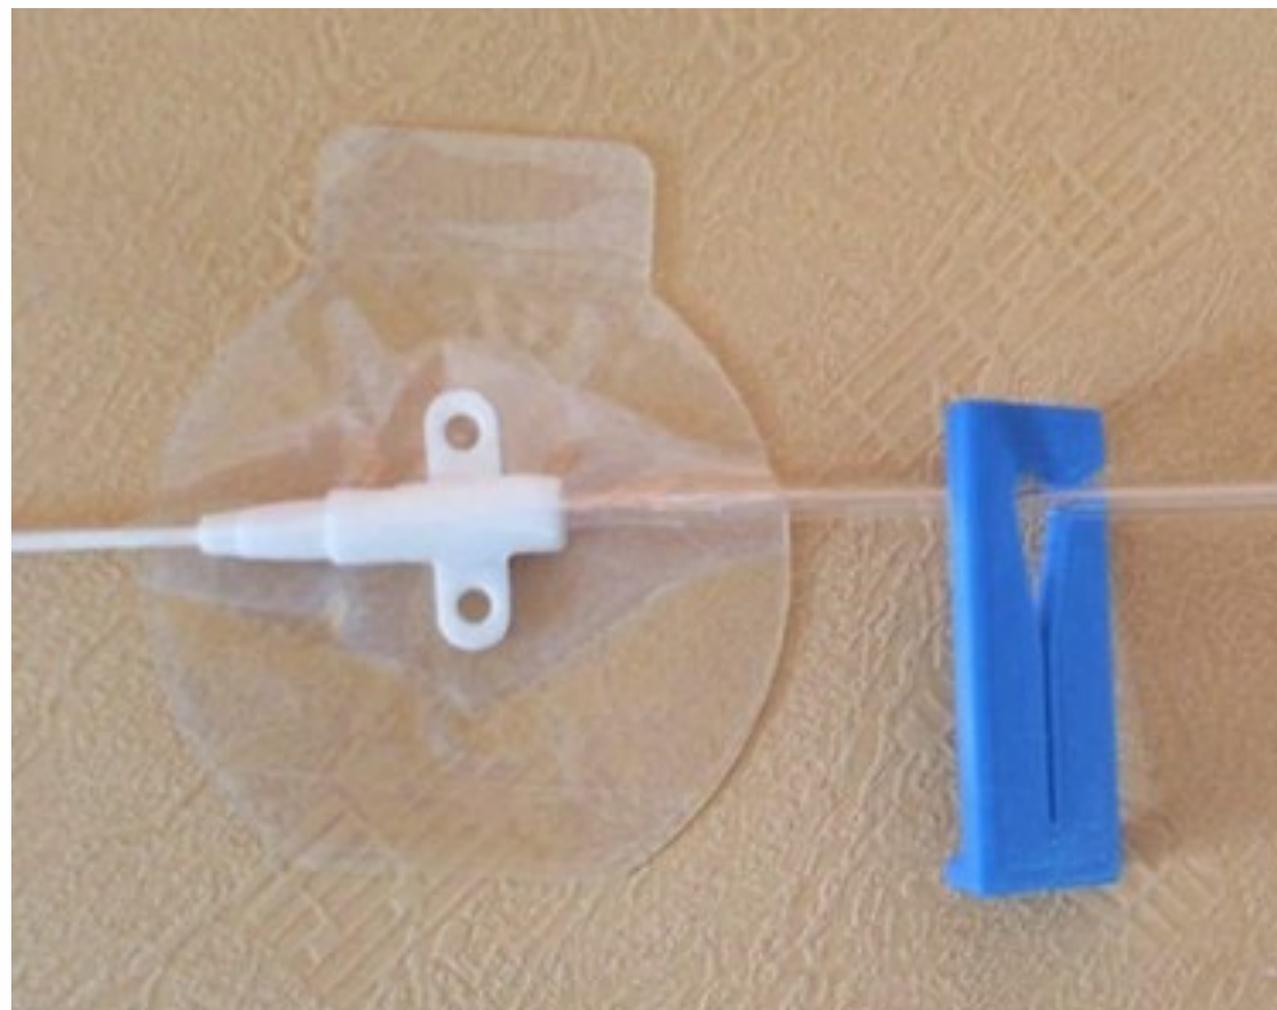

# Neo Velum

PERMITE REPOSICIONAMENTO DO TUBO

FILME DE FECHAMENTO SUPERIOR TRANSPARENTE

PERMITE VISUALIZAÇÃO DIRETA

DISPONÍVEL EM QUATRO TAMANHOS E VERSÕES



# Sil-Fixx Cannuguard

FIXADOR PARA CATETER FENESTRADO EM SILICONE

FINALIDADE: FIXAÇÃO DE CATETERES E PROTEÇÃO

**INDICAÇÃO: PACIENTES ALÉRGICOS À COLA ADESIVA DE ACRYLATO, PRESENTE NOS FIXADORES CONVENCIONAIS**

CARACTERÍSTICAS:

REMOÇÃO SEM TRAUMA, SUAVE, REPOSICIONÁVEL

VEM COM DUAS TIRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER



# Sil-Fixx

## FITA ADESIVA SILICONE

FINALIDADE: TODO TIPO DE FIXAÇÃO E PROTEÇÃO

**INDICAÇÃO: PACIENTES ALÉRGICOS À COLA ADESIVA DE ACRYLATO, PRESENTE NAS FITAS ADESIVAS CONVENCIONAIS**

CARACTERÍSTICAS:

REMOÇÃO SEM TRAUMA, SUAVE, REPOSICIONÁVEL

A PROVA D'ÁGUA, PERMITE PACIENTE IR AO BANHO

COM LINHA DE PRÉ-CORTE, DISPENSA O USO DE TESOURA



# Siltape

## FITA ADESIVA SILICONE

FINALIDADE: TODO TIPO DE FIXAÇÃO E PROTEÇÃO

**INDICAÇÃO: PACIENTES ALÉRGICOS À COLA ADESIVA DE ACRYLATO, PRESENTE NAS FITAS ADESIVAS CONVENCIONAIS**

CARACTERÍSTICAS:

REMOÇÃO SEM TRAUMA, SUAVE, REPOSICIONÁVEL

COM LINHA DE PRÉ-CORTE, DISPENSA O USO DE TESOURA



# Neo Snug

## POSICIONADOR NEONATO

FINALIDADE:

IMITA O POSICIONAMENTO DO BEBÊ, QUANDO AINDA ESTÁ NO ÚTERO.

FLEXIONADO

CABEÇA NA LINHA MÉDIA, PESCOÇO EM NEUTRO

OMBRO EM PROTAÇÃO

MÃOS E BOCA NA LINHA MÉDIA

QUADRIS E PÉS EM NEUTRO



## Neo Hug

POSICIONADOR

FINALIDADE:

AUXILIAR NO POSICIONAMENTO DE PREMATUROS E  
NEONATOS.



# Neo Hug

## CARACTERÍSTICAS:

- MOLDÁVEL, ESTÁVEL, CAPAS LAVÁVEIS.
- SUBSTITUI OS “ROLINHOS” IMPROVISADOS COM ROUPA DE CAMA.



# Neo Teneo

## COLCHÃO DE GEL

FINALIDADE: REDUZIR AS ÁREAS DE PRESSÃO CAUSADA POR IMOBILIDADE PROLONGADA(ex. ventilação assistida) E ABSORVER AS VIBRAÇÕES E RUÍDOS ORIUNDAS DOS EQUIPAMENTOS(efeitos sobre sistema cardiovascular, eixo pituitário-adrenal e auditivo do recém nascido).

PREVINE MOLDE BILATERAL DE CABEÇA(PLAGIOCEFALIA)

CARACTERÍSTICAS:

CONFECCIONADO EM TPU(POLIURETANO TERMOPLÁSTICO), GEL ATÓXICO, COM EXPANSOR DE VOLUME PLASMÁTICO, MACIO E SUAVE, PROTEGE A PELE DO BEBÊ.




## Ocular Exam Kit

KIT PARA EXAME OCULAR

FINALIDADE

ASSISTÊNCIA EM EXAMES OCULARES

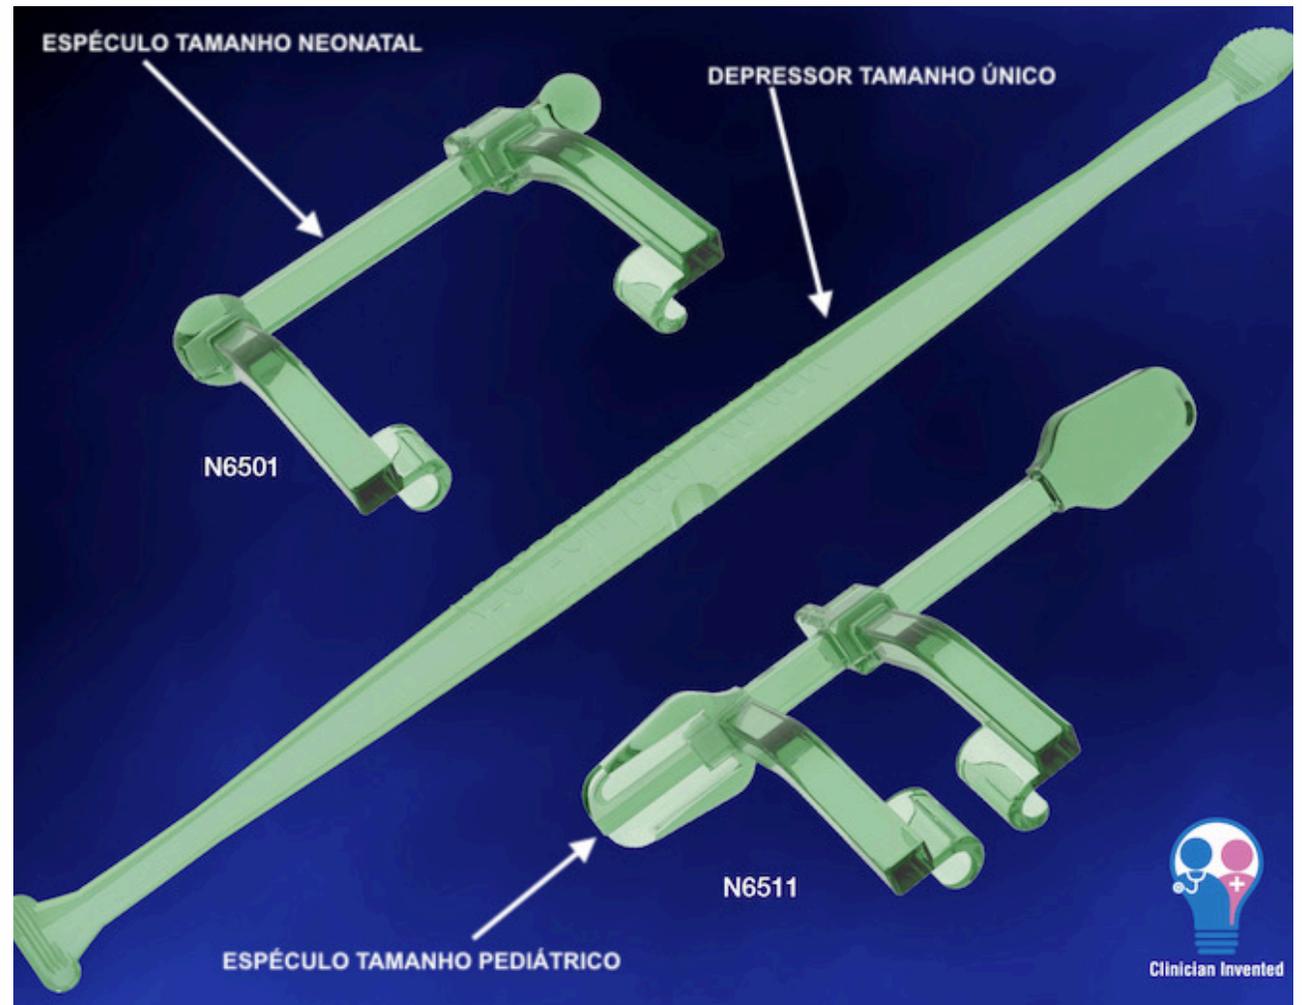

# Ocular Exam Kit

## CARACTERÍSTICAS:

ESTÉRIL, PRONTO PARA USO

COMPOSTO POR ESPÉCULO E DEPRESSOR

TRAVA NO LUGAR POR PRESSÃO DAS  
PALPEBRAS

PERMITE VISÃO IRRESTRITA

ABRE E FECHA FACILMENTE

**ESPÉCULO NEONATAL IDEAL PARA EXAME  
ROP (RETINOPATIA DA PREMATURIDADE)**

**DEPRESSOR DE DOIS LADOS COM TEXTURA  
INOVADORA PARA SEGURAR A CONJUNTIVA  
SUAVEMENTE**

